

監控點圖表


監控點: 666-急診BI-臨床藥局-PHCL-C020-(上)

時間區間: 2025-04-30 11:00 ~ 2025-06-02 10:52

最大值: -16.9 °C

最小值: -20.1 °C

平均值: -18.7 °C

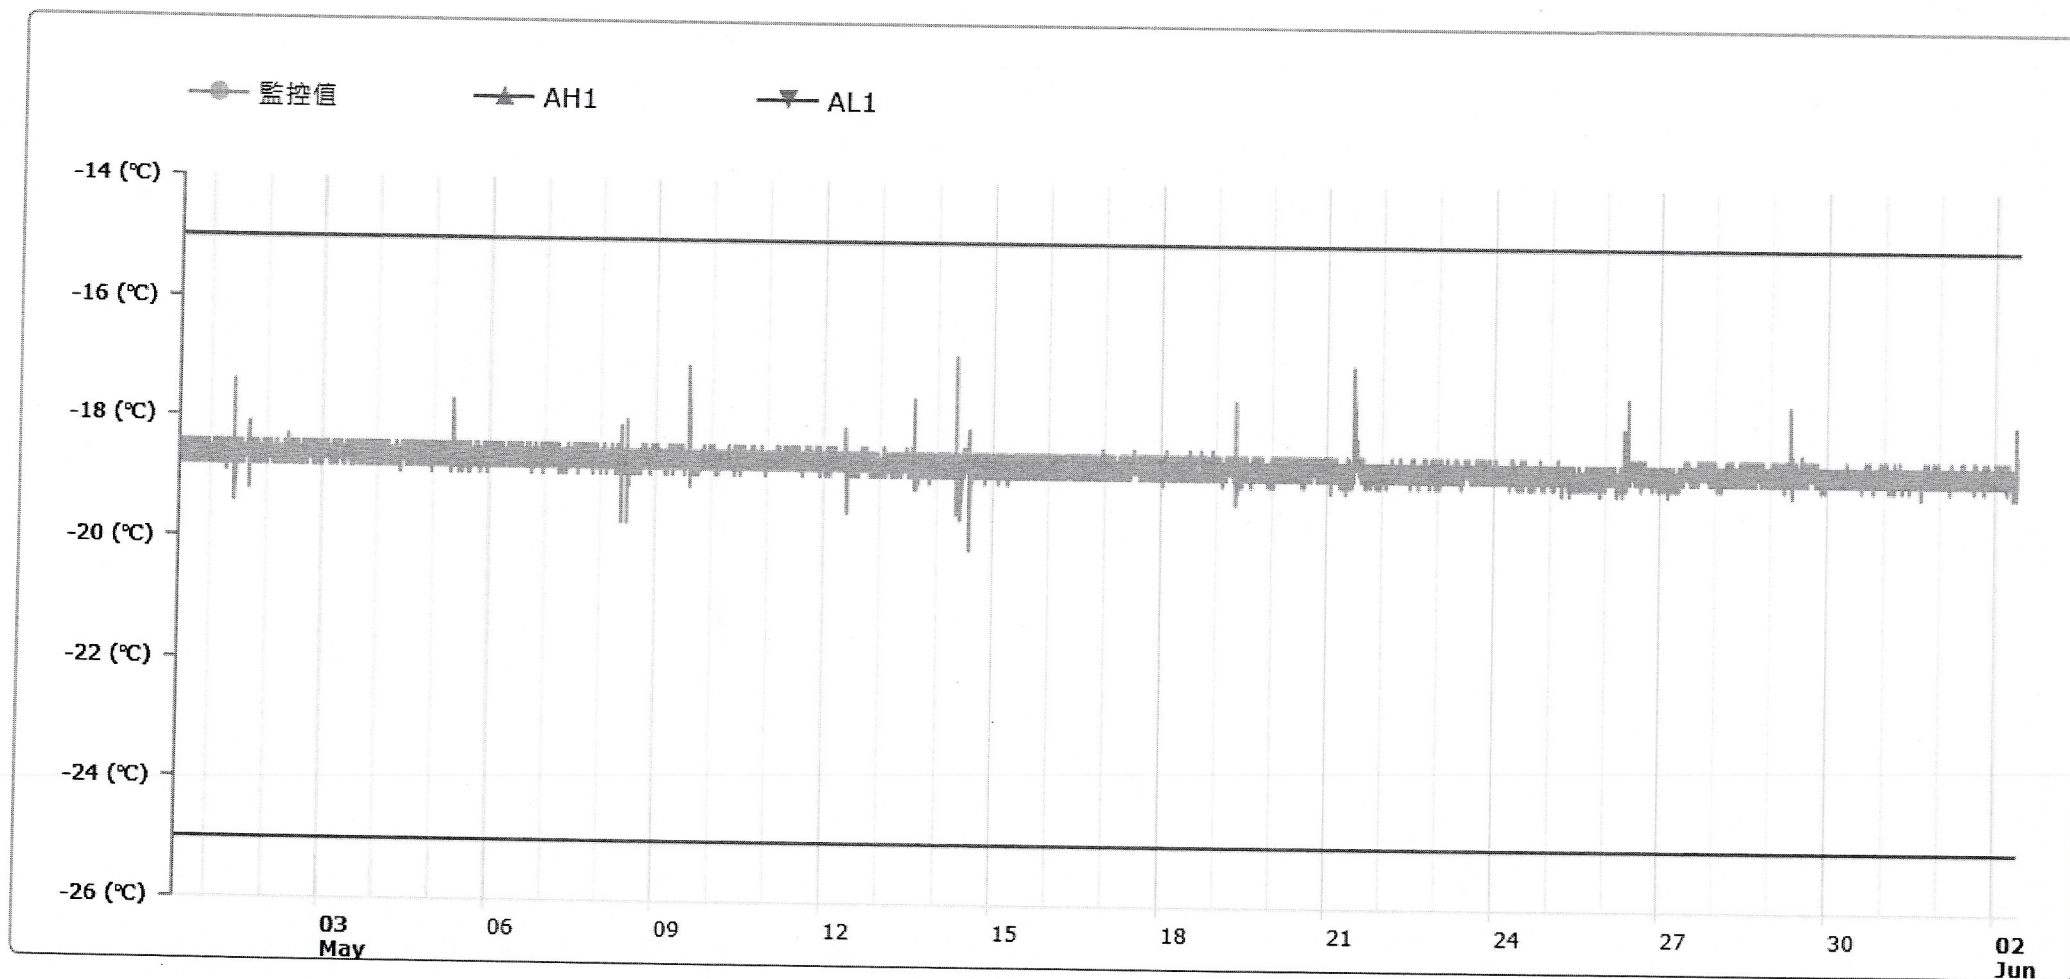

製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yvonne Su
02 Jun 2025

單位主管:

藥學部 劉兆鴻 0602
主任 1400