

監控點圖表


監控點: 667-急診B1-臨床藥局-PHCL-C020-(下)

時間區間: 2026-01-30 17:00 ~ 2026-03-02 08:50

最大值: -18.4 °C

最小值: -20.1 °C

平均值: -19.2 °C

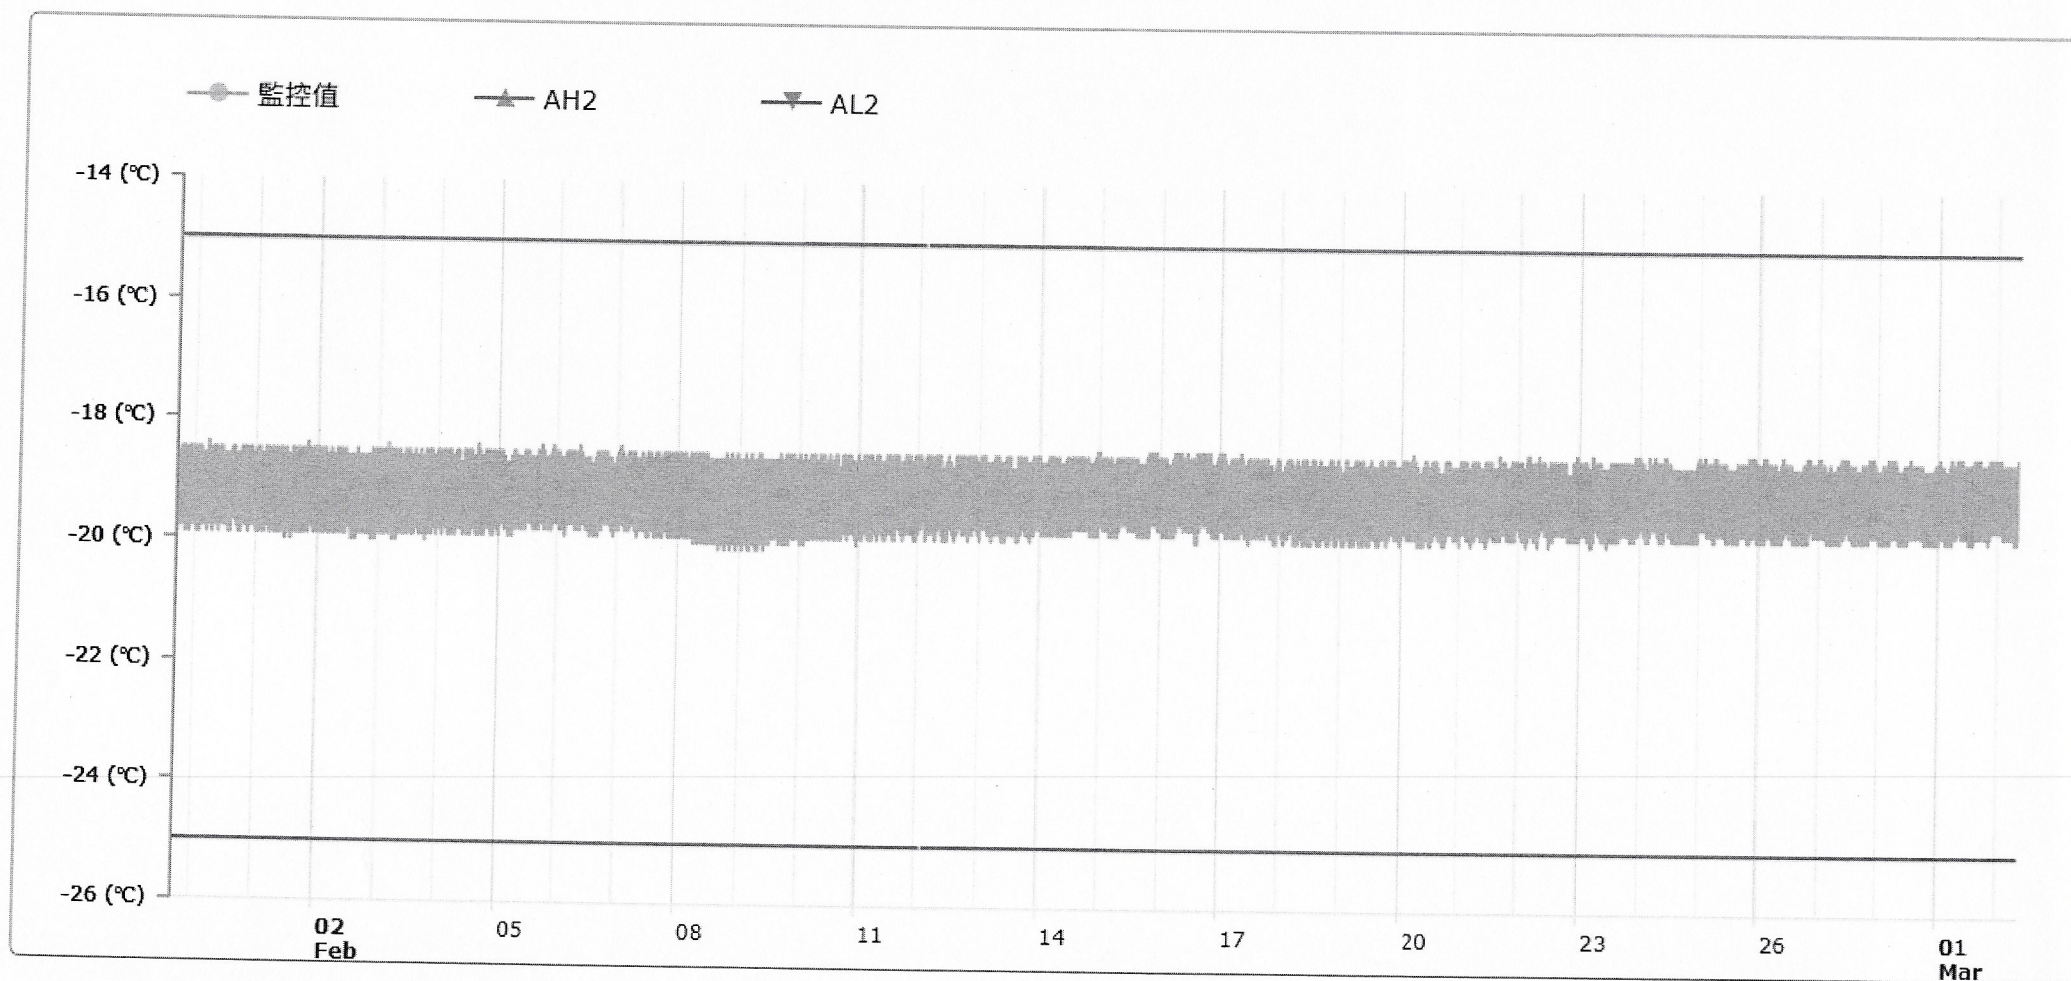

製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

juansu
02 Mar 2026

單位主管:

藥學部 劉兆鴻 0302
科主任 1100