

監控點圖表


監控點: 155-急診4F-檢體儲存室-80°C-2-下

時間區間: 2025-11-01 00:00 ~ 2025-11-30 23:59

最大值: -72.1 °C

最小值: -81.8 °C

平均值: -79.6 °C

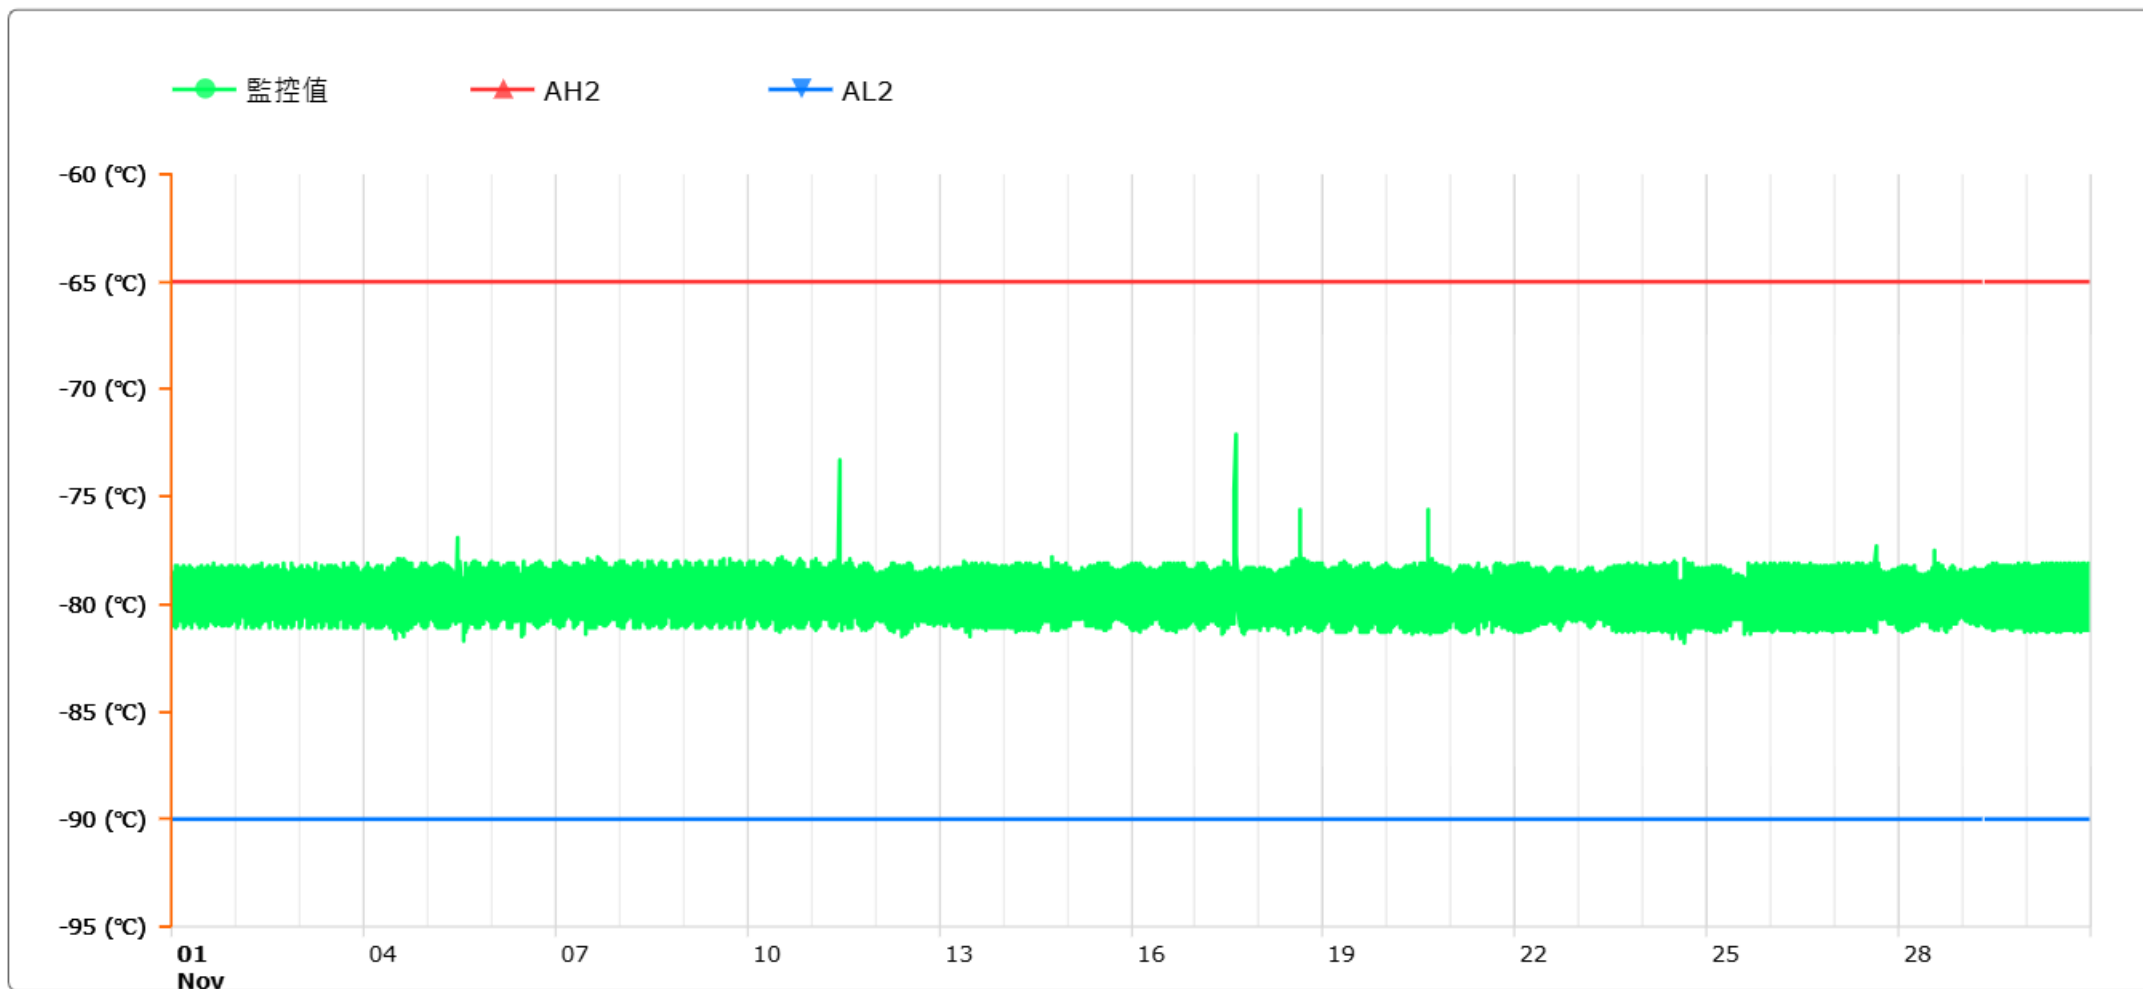

製表者: 臨床試驗中心

單位主管: