

監控點圖表


監控點: 667-急診B1-臨床藥局-PHCL-C020-(下)

時間區間: 2026-06-30 12:00 ~ 2026-08-04 14:18

最大值: -18.3 °C

最小值: -19.8 °C

平均值: -19.0 °C

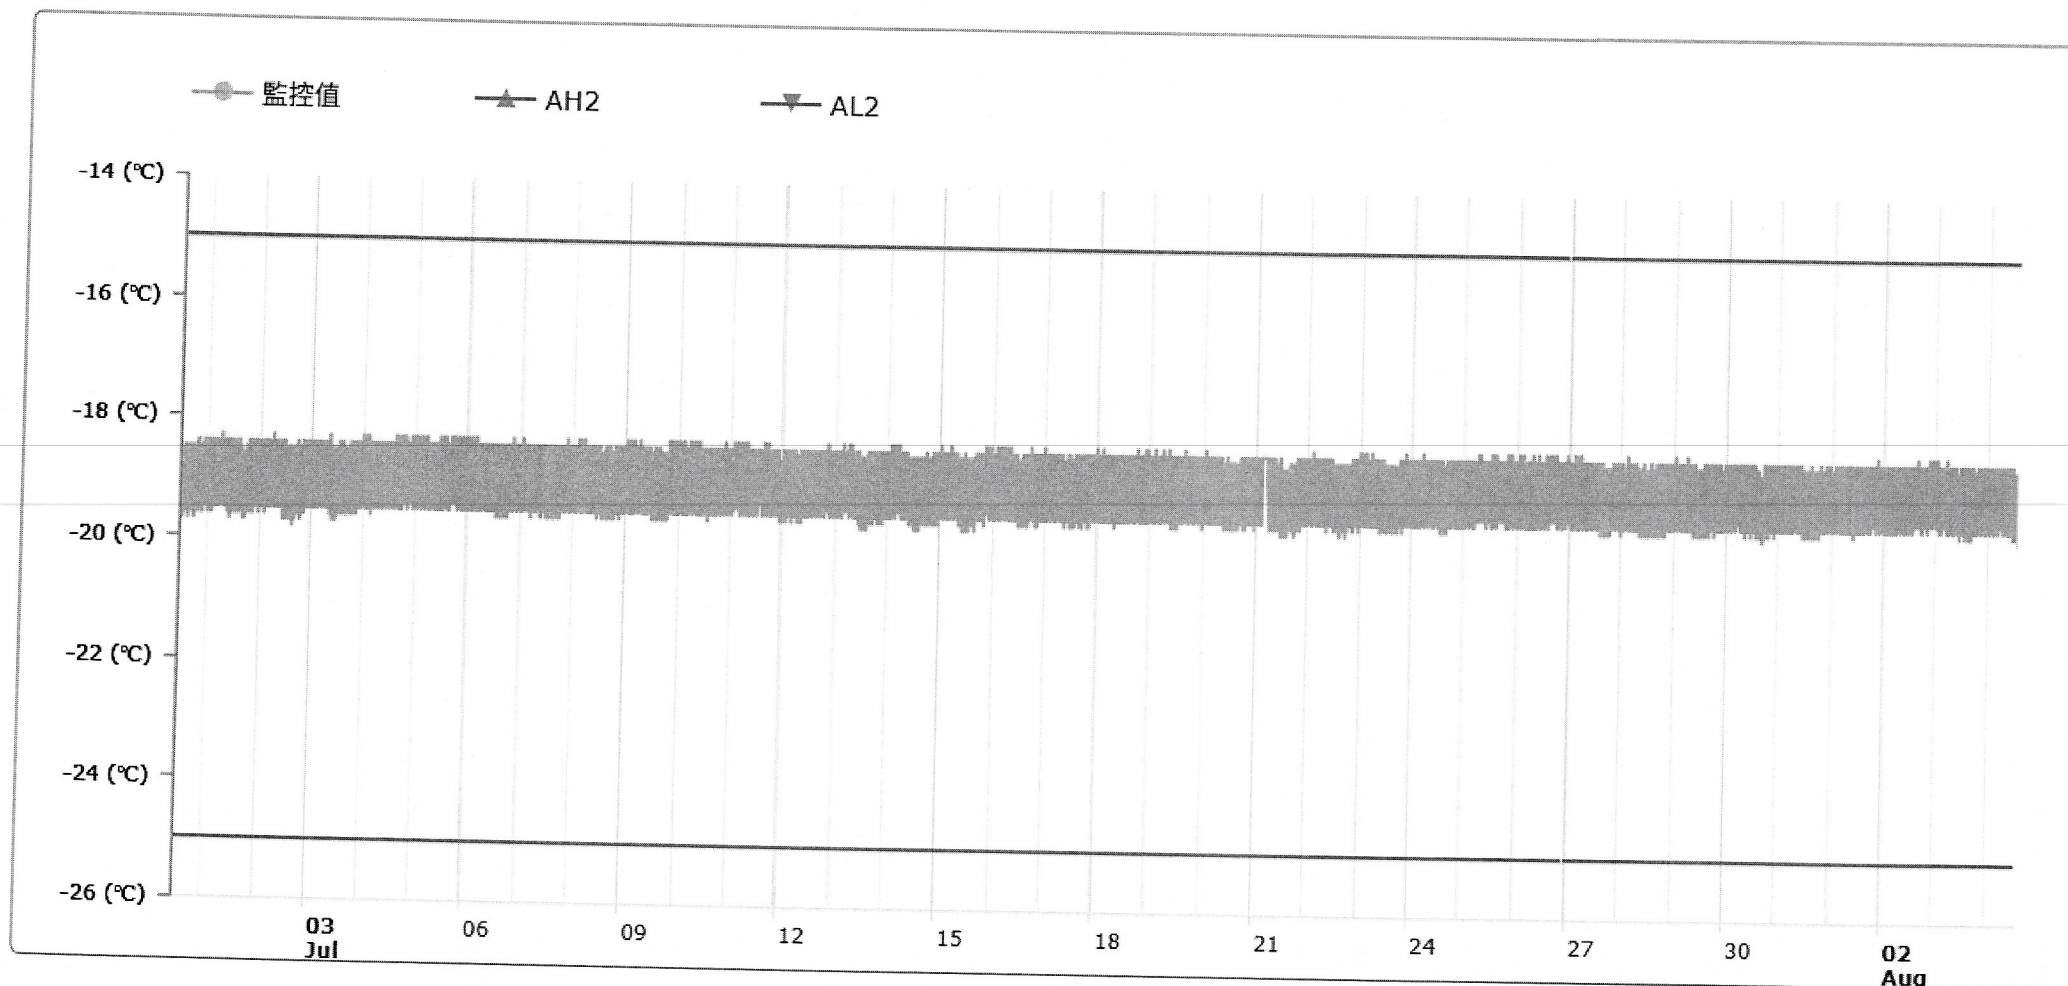

製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yuchen
05 Aug 2026

單位主管:

藥學部劉兆鴻 0805
科主任 1500