

監控點圖表


監控點: 667-急診B1-臨床藥局-PHCL-C020-(下)

時間區間: 2026-07-31 13:00 ~ 2026-09-01 10:19

最大值: -18.3 °C

最小值: -19.8 °C

平均值: -19.0 °C

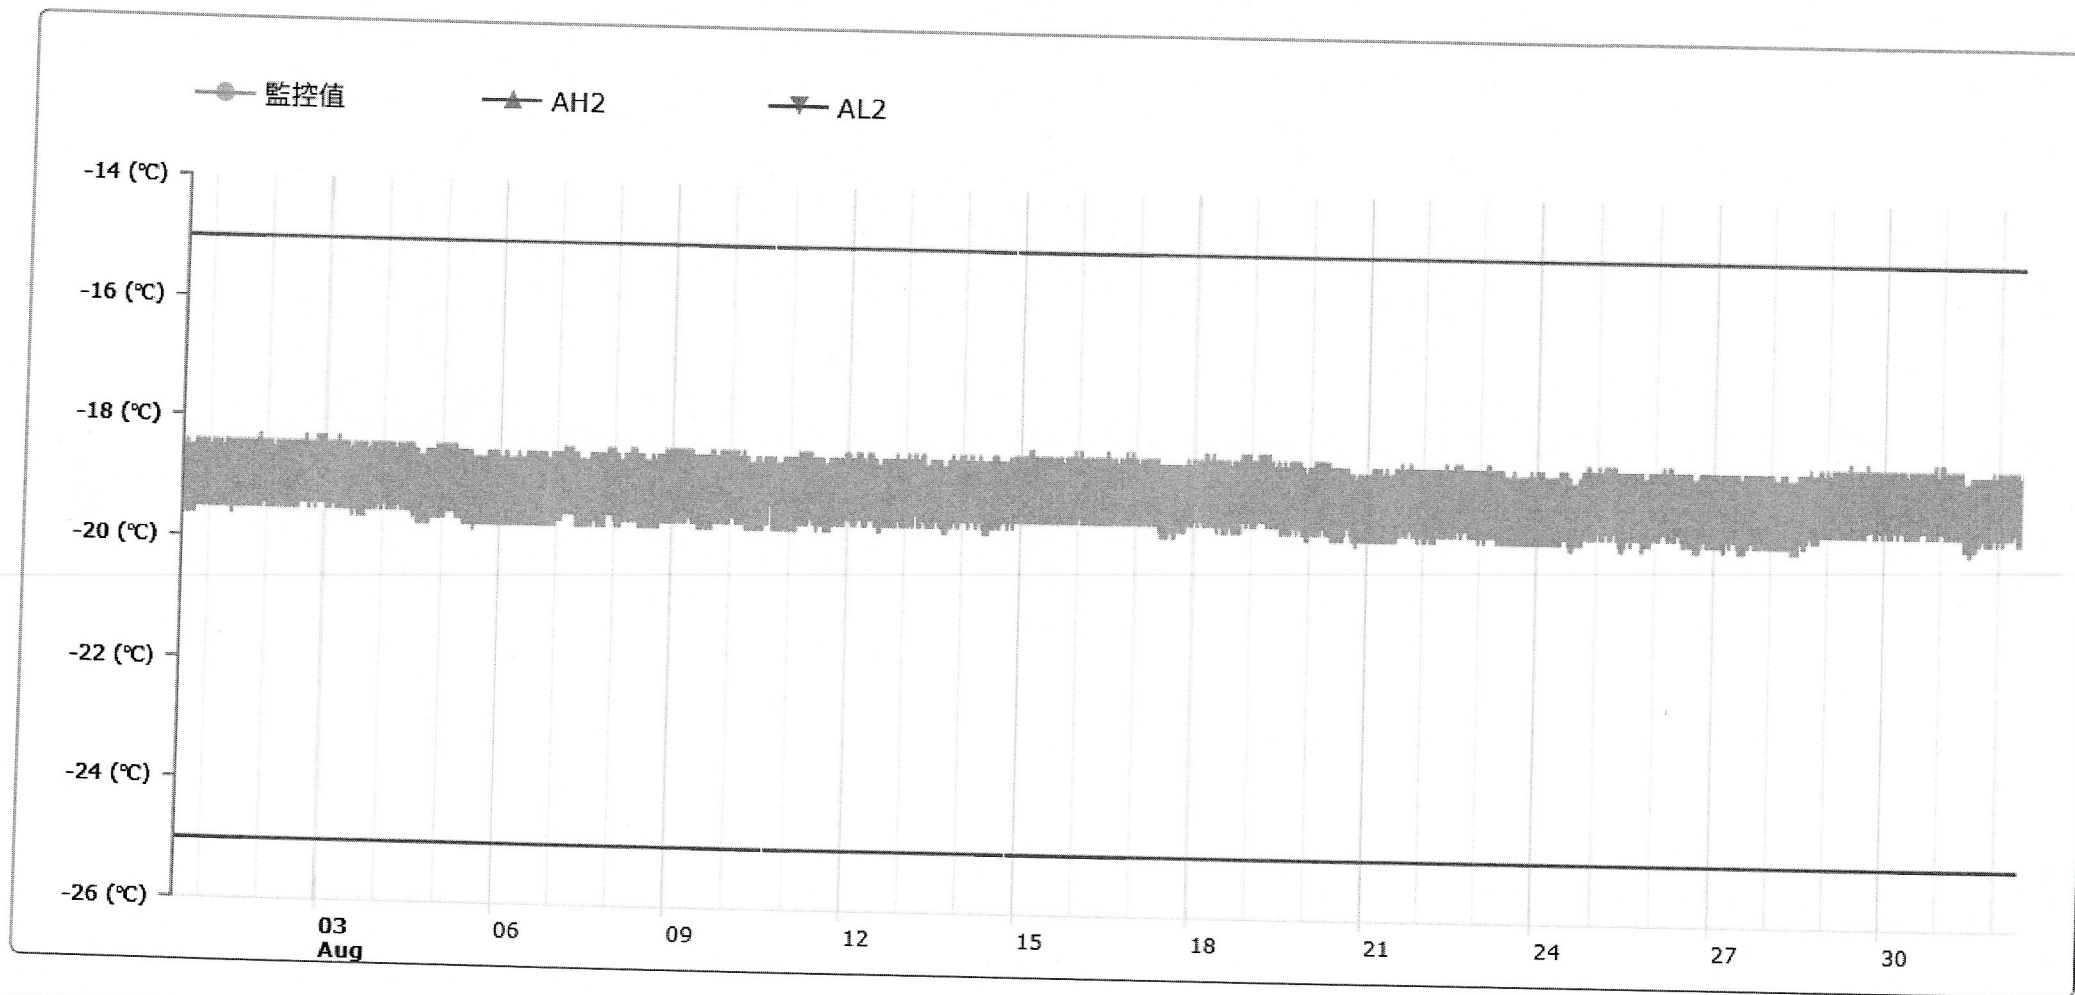

製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yuma
01 Sep 2026

單位主管:

藥學部劉兆鴻 0901/1300
科主任