


監控點圖表

監控點: 547-急診B1-臨床藥局-PHCL-C017-(下)

時間區間: 2025-01-27 17:30 ~ 2025-03-06 07:58

最大值: -69 °C 最小值: -81.5 °C 平均值: -79.4 °C

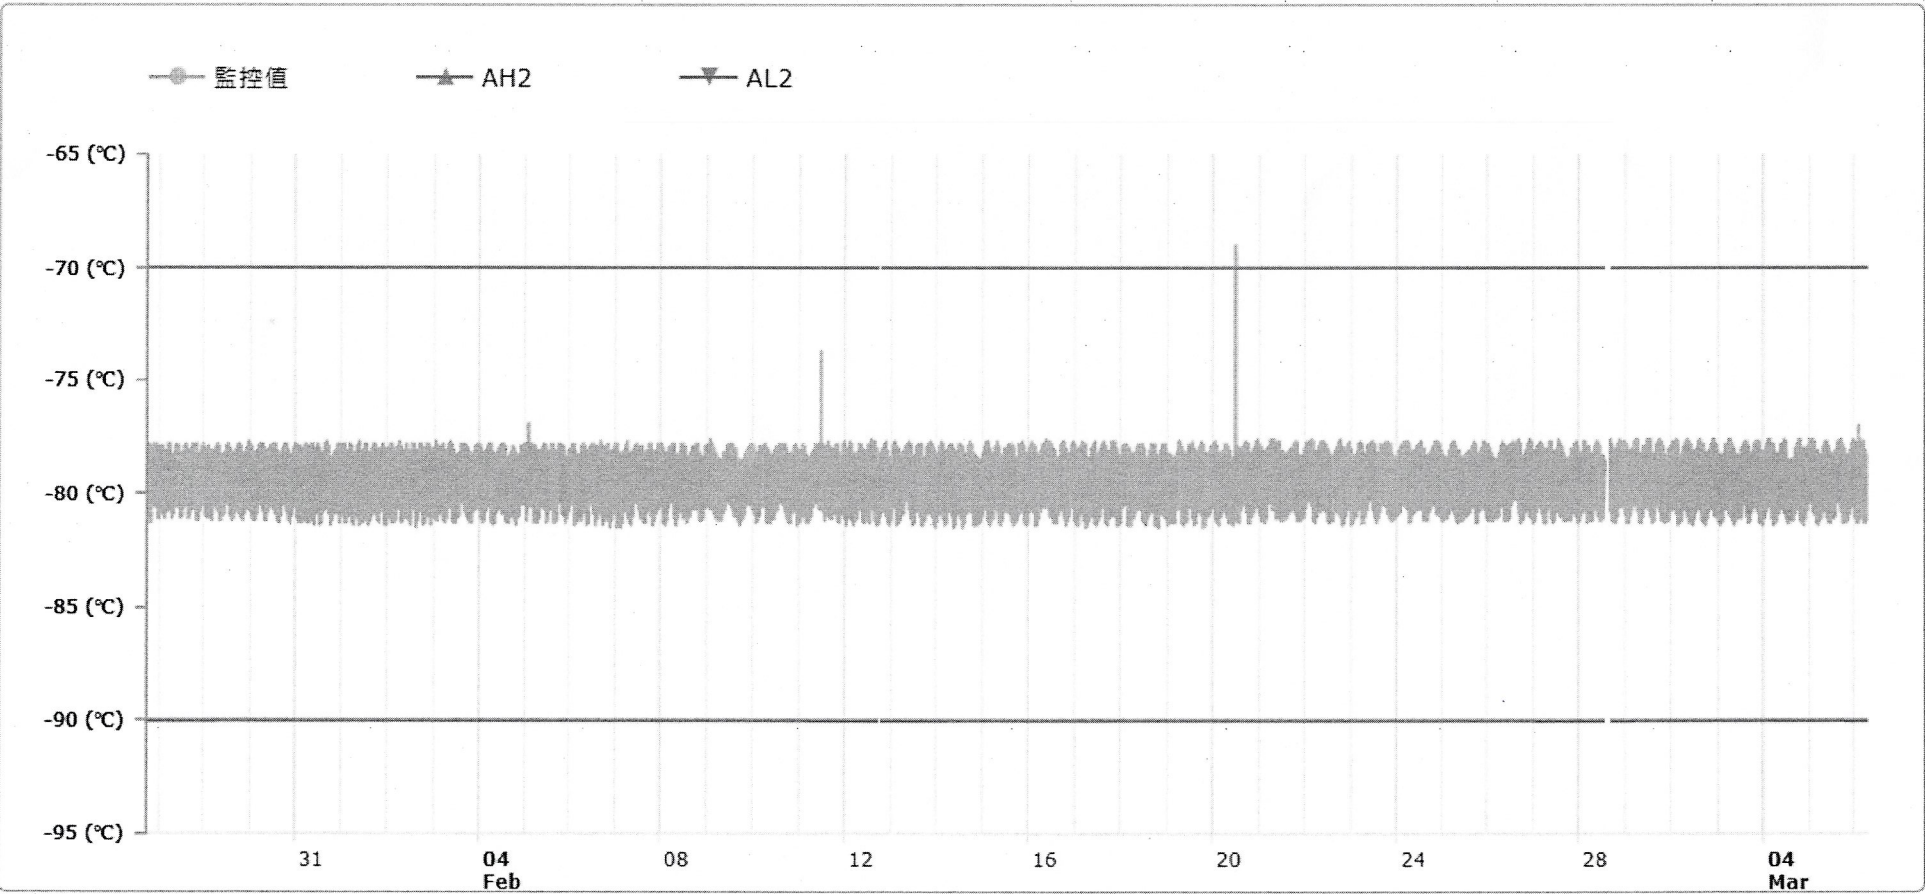

製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

YumenSu
06 Mar 2025

單位主管:

藥學部 劉兆鴻 0306
科主任 金 0945

Not to file

冷凍櫃 PHCL-C017 設定的溫度範圍為 -70°C 至 -90°C ，是根據不同試驗案的試驗藥品需求來設定。目前存放於 PHCL-C017 的 V940-002 試驗案，試驗藥品可接受的溫度範圍為 -60°C 至 -90°C ，因此即使冷凍櫃的上限設定為 -70°C ，該藥品仍處於允許範圍內，沒有超溫的問題。

The temperature range of freezer PHCL-C017 is set between -70°C and -90°C , based on the storage requirements of trial medications for different clinical studies.

The V940-002 trial medication currently stored in this freezer has an acceptable temperature range of -60°C to -90°C . Therefore, even with the freezer's upper limit set at -70°C , the medication remains within the permitted range, with no risk of temperature deviation.

Yuanen Su 06 Mar 2015