

監控點圖表


監控點: 571-急診BI-臨床藥局-PHCL-C010-(上)

時間區間: 2026-01-30 17:00 ~ 2026-03-02 08:50

最大值: -80.5 °C

最小值: -81.8 °C

平均值: -81.1 °C

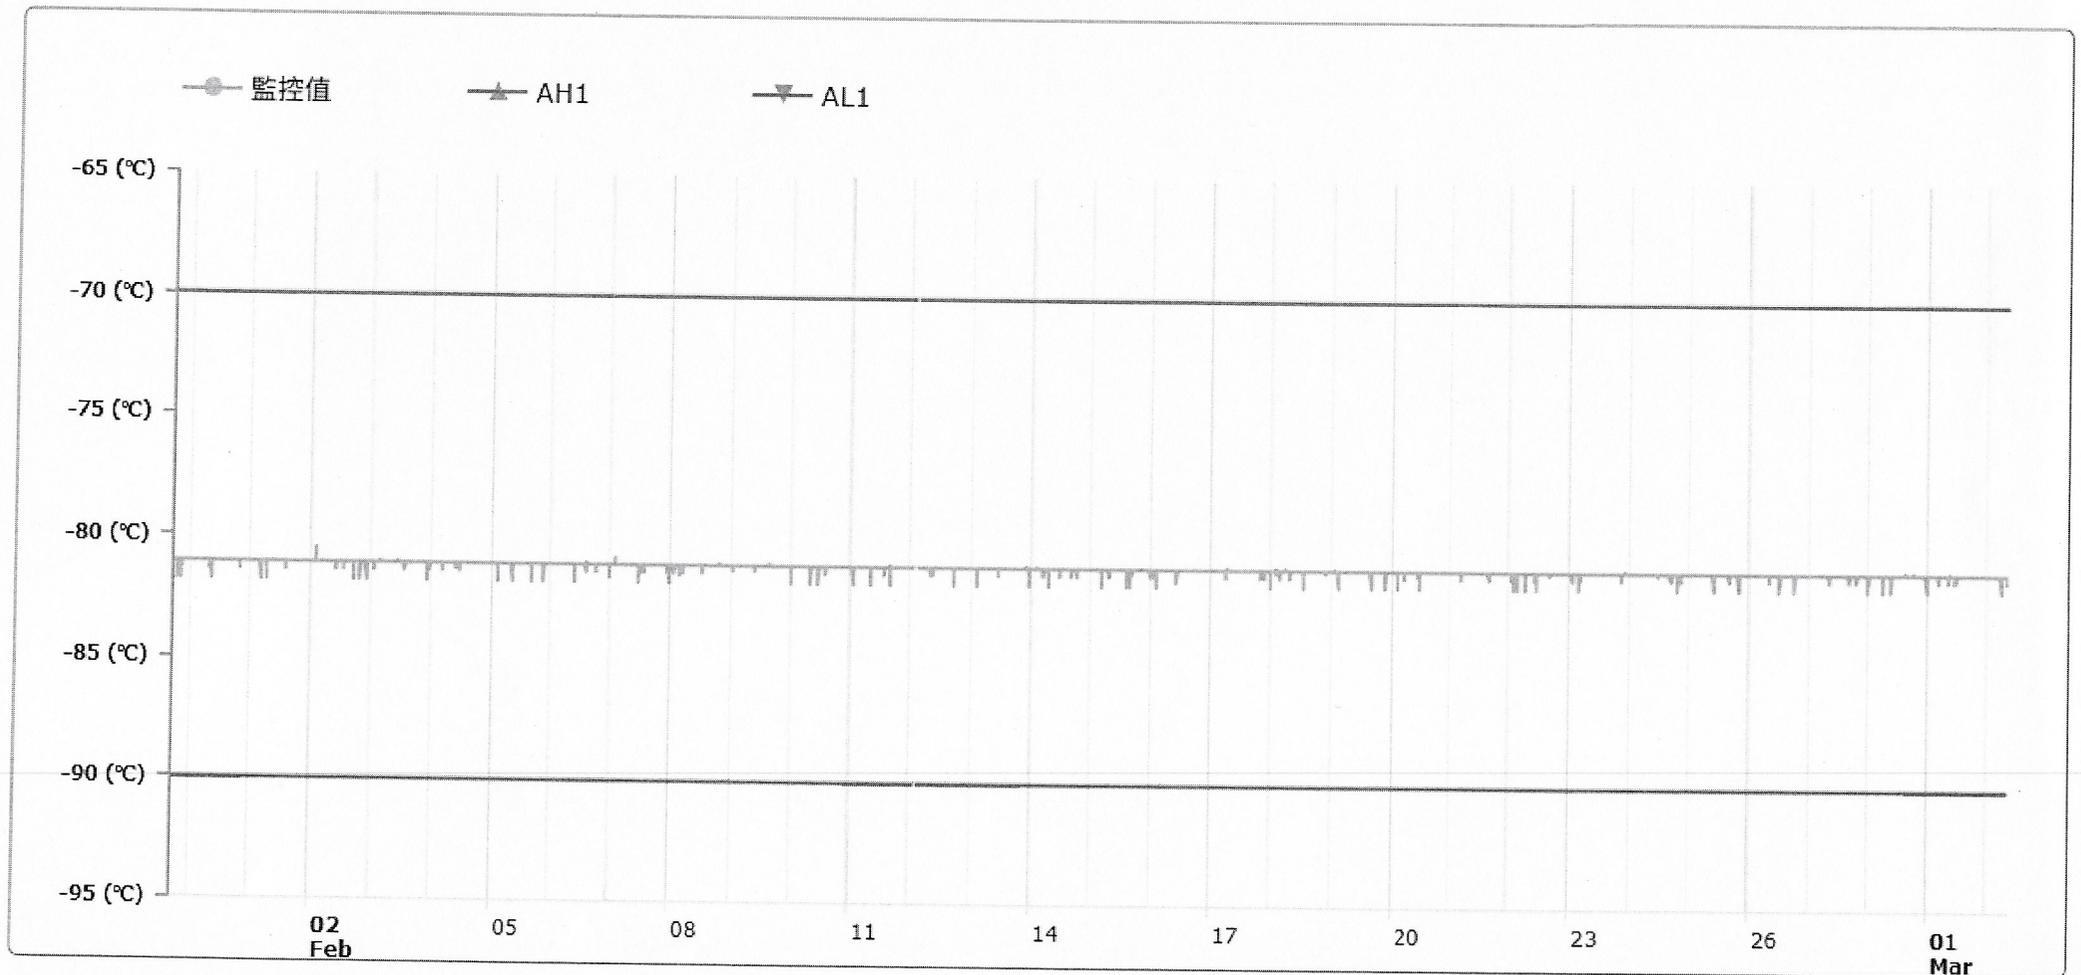

製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yumei Su
02 Mar 2026

單位主管:

藥學部 劉兆鴻 0302
科主任 1100