

監控點圖表


監控點: 666-急診BI-臨床藥局-PHCL-C020-(上)

時間區間: 2026-06-30 12:00 ~ 2026-08-04 14:18

最大值: -16.6 °C

最小值: -19.3 °C

平均值: -17.7 °C

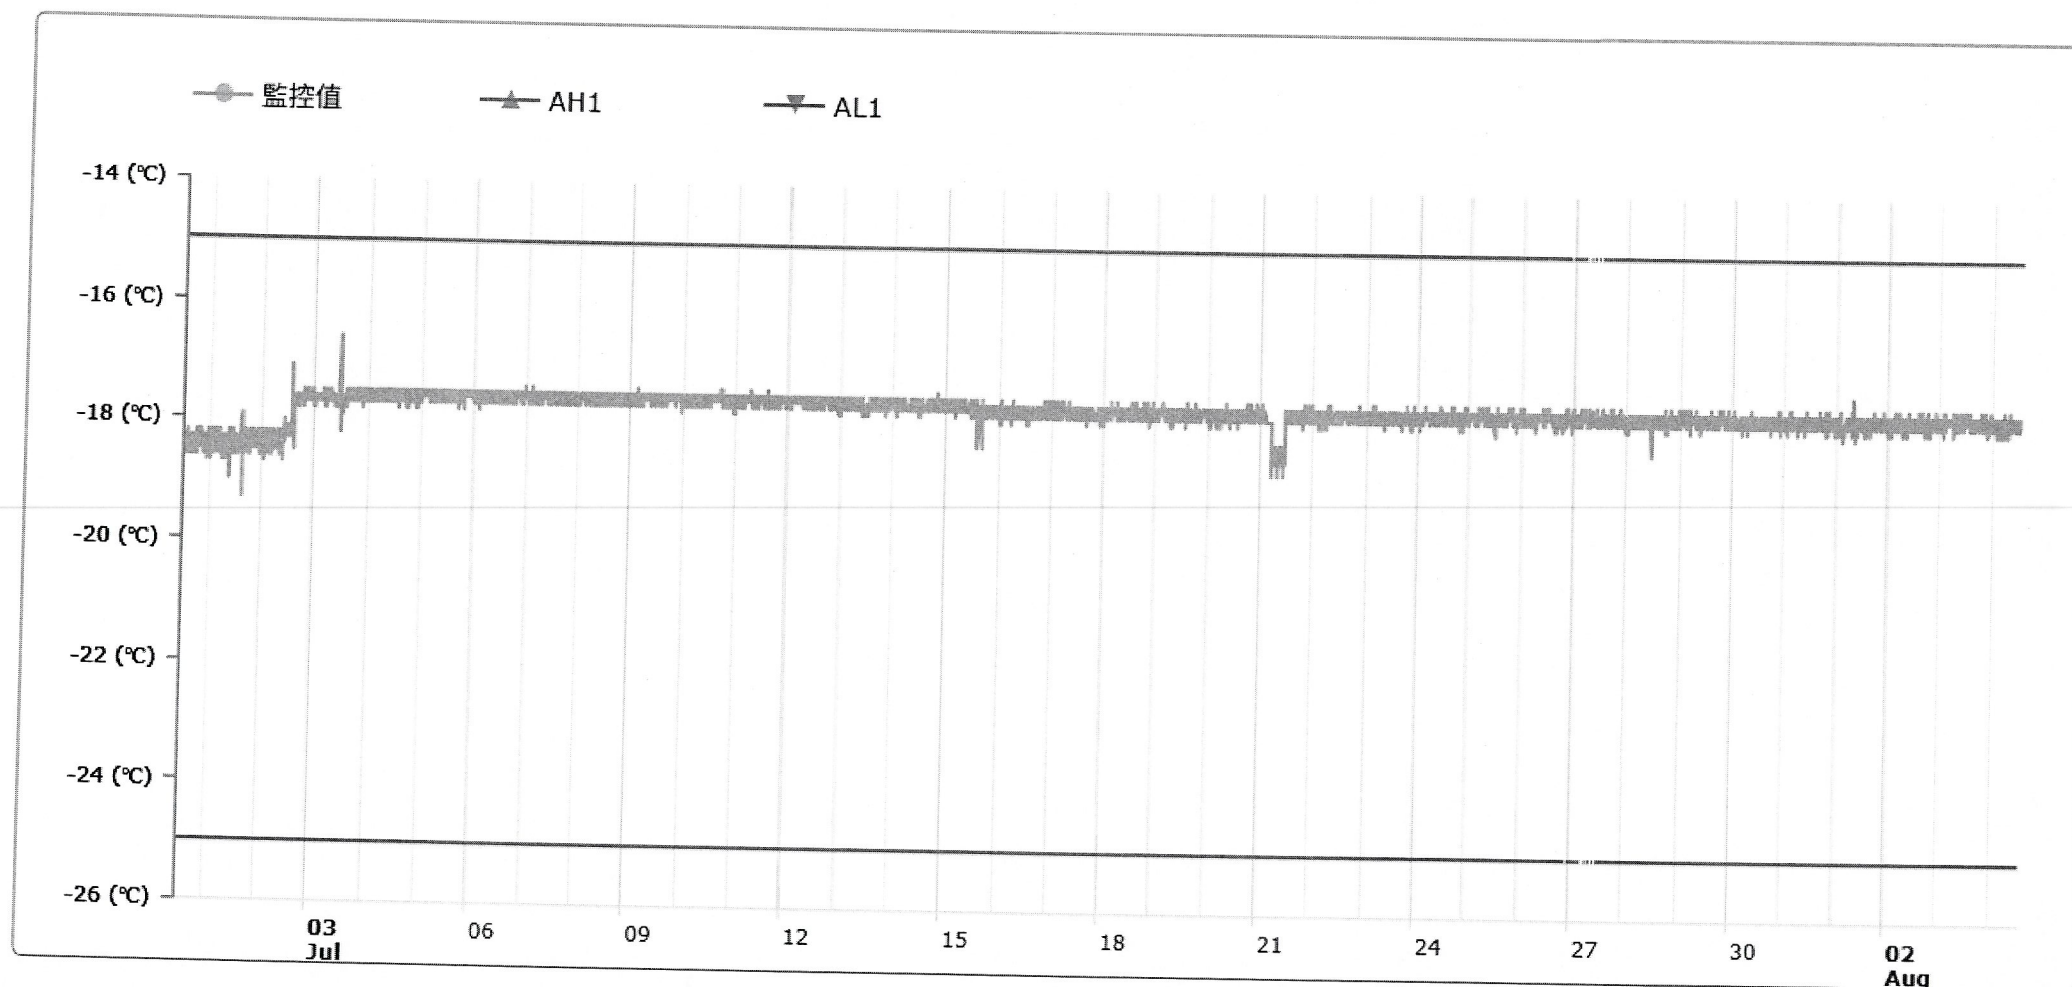

製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yucnes
05Aug 2026

單位主管:

藥學部劉兆鴻 0805
科主任劉兆鴻 1500