

監控點圖表


監控點: 528-急診BI-臨床藥局-PHCL-C004-(下)

時間區間: 2023-04-28 11:00 ~ 2023-06-01 14:02

最大值: -18.1 °C

最小值: -20.6 °C

平均值: -19.4 °C

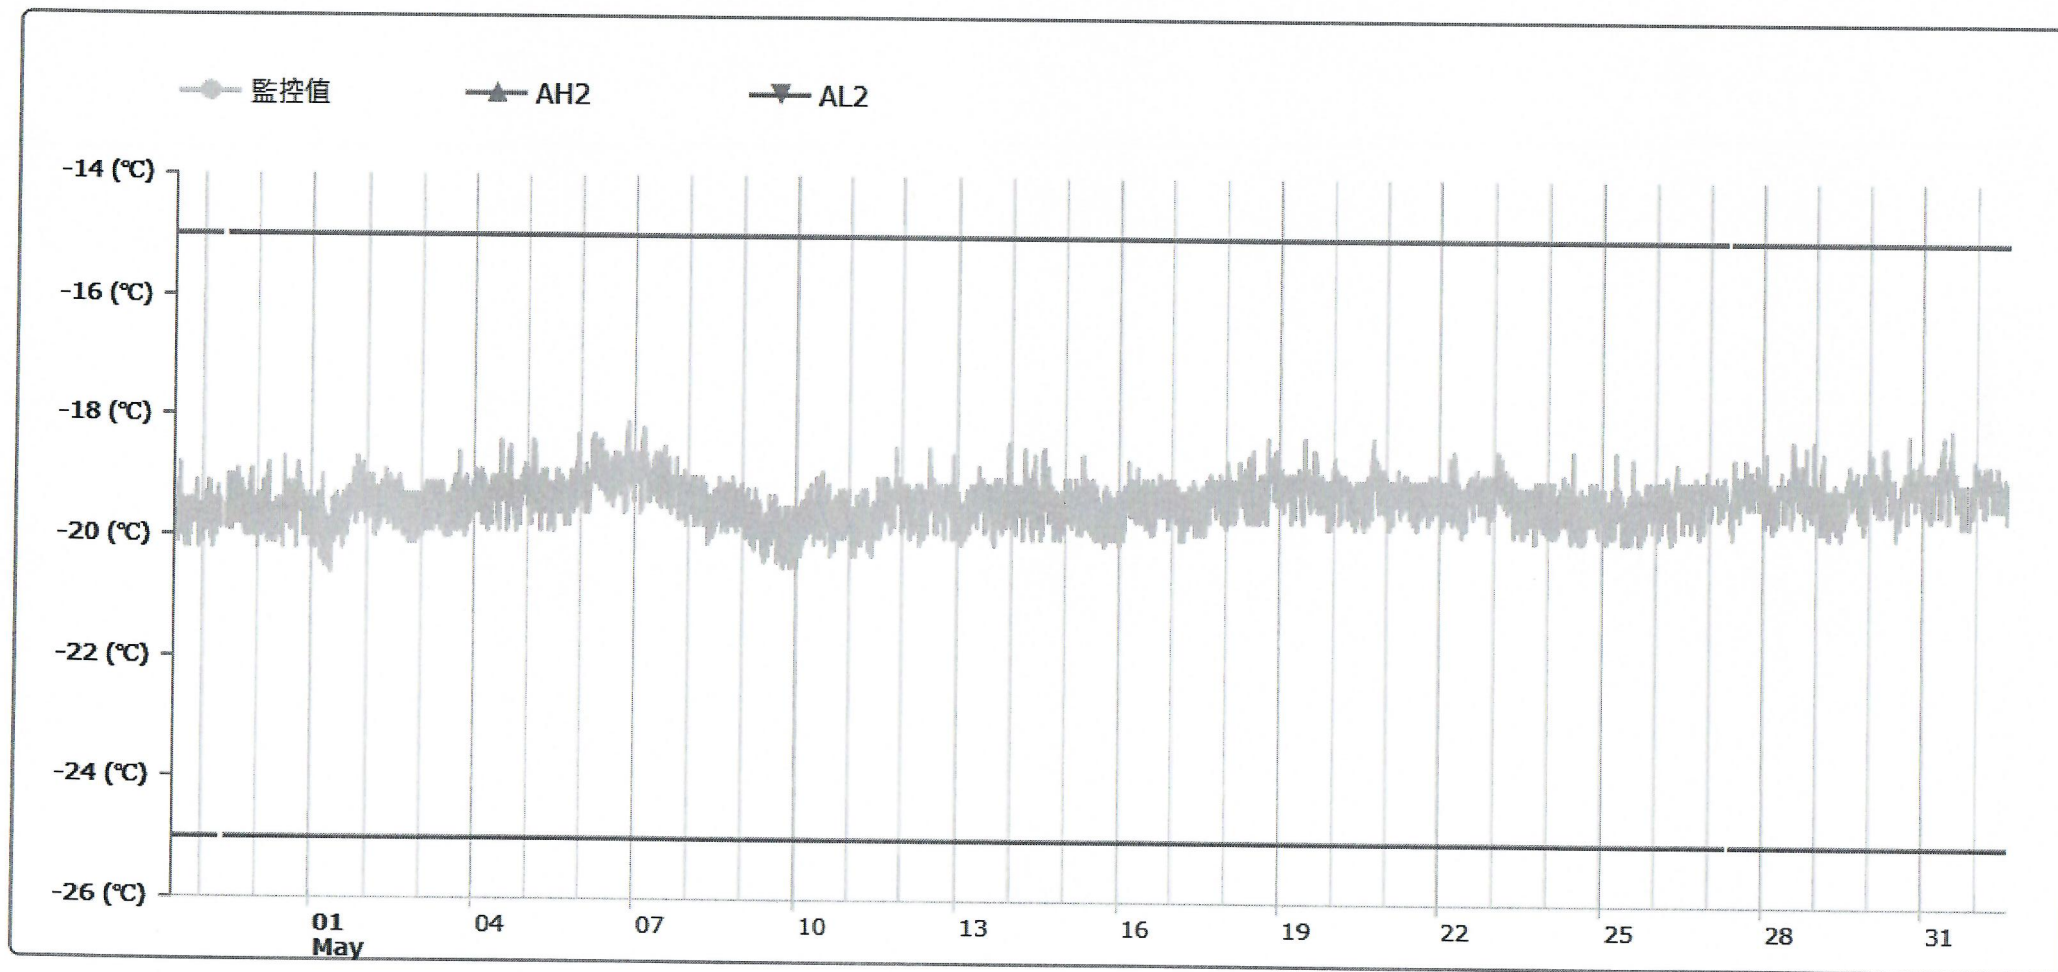

製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真 YuamenSu
01 Jun 2023

單位主管: 藥學部 陳秀美 0601/635
科主任