

監控點圖表


監控點: 153-急診4F-檢體儲存室-80℃-1-下

時間區間: 2024-10-01 00:00 ~ 2024-10-31 23:59

最大值: -70 °C

最小值: -91.6 °C

平均值: -80.1 °C

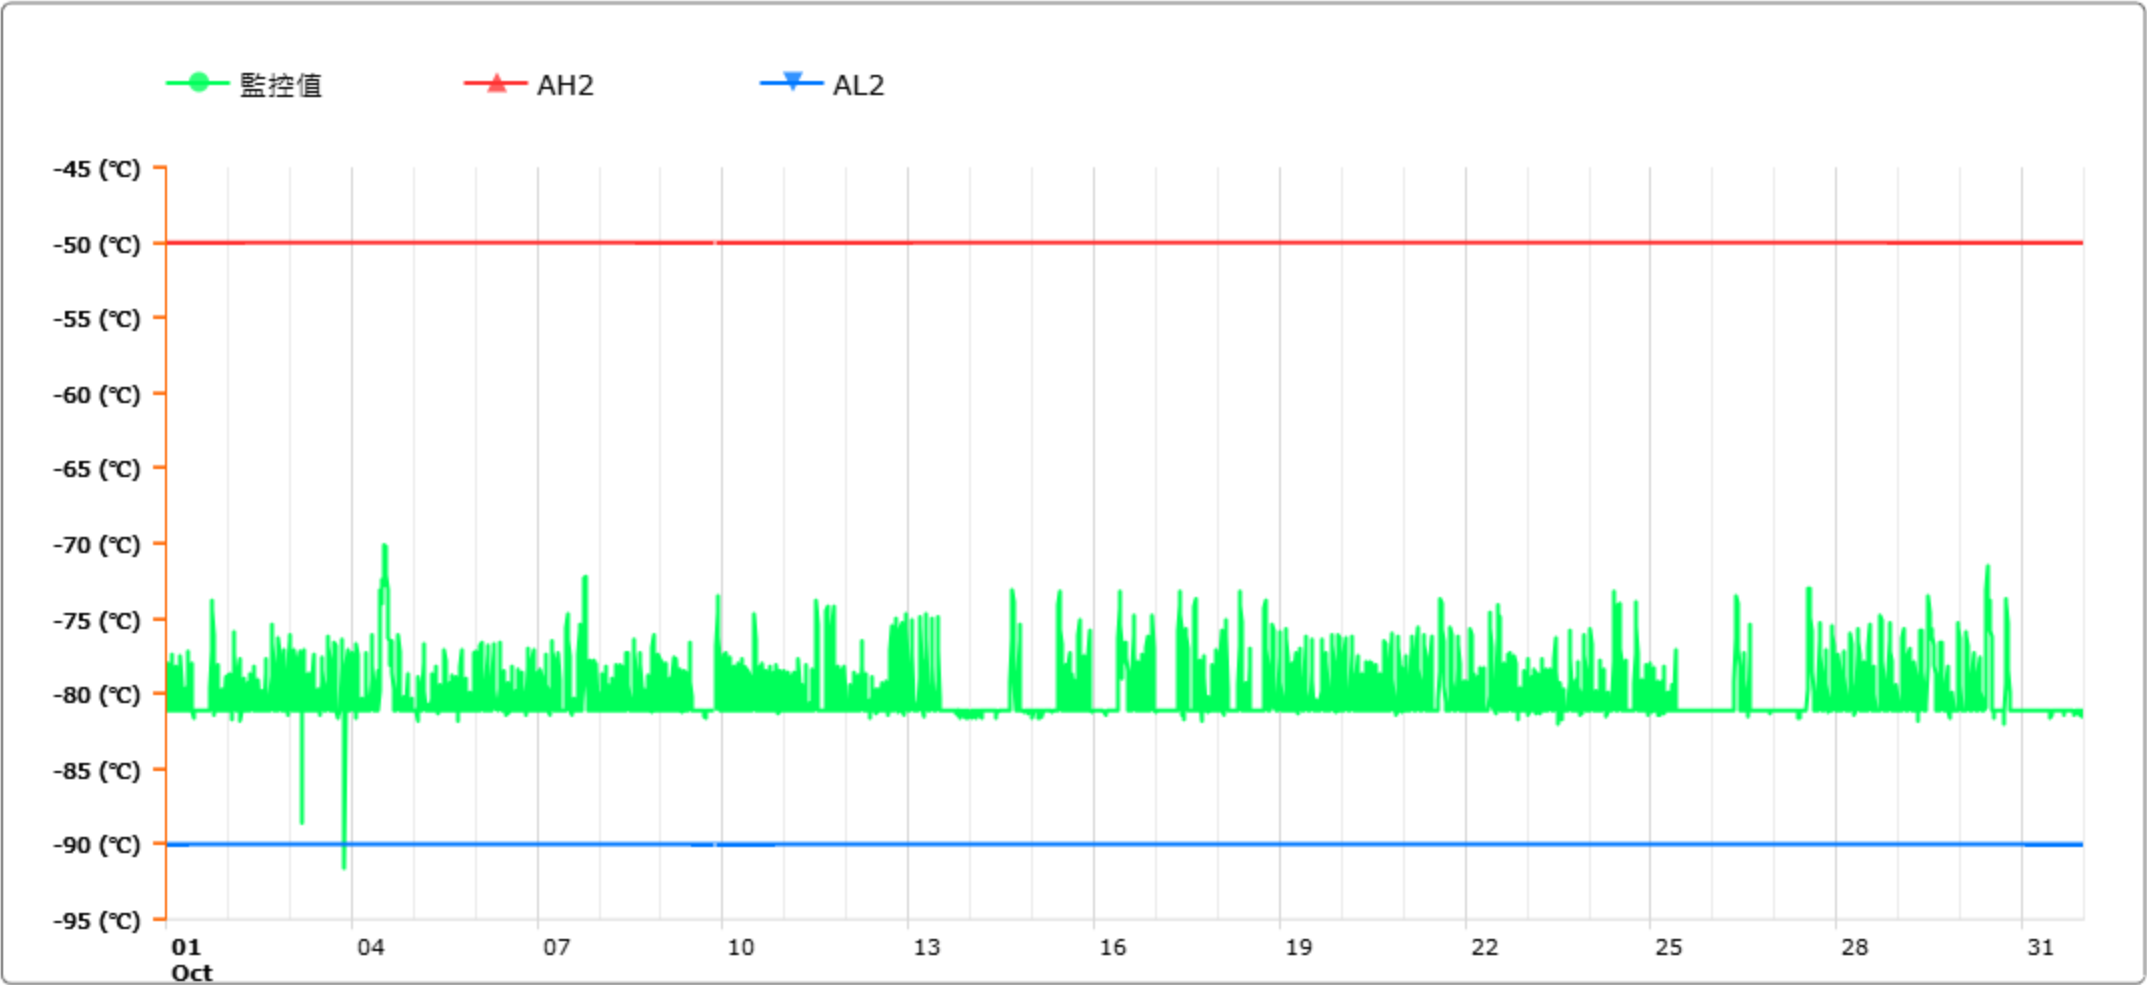

製表者: 臨床試驗中心

單位主管: