

監控點圖表


監控點: 547-急診BI-臨床藥局-PHCL-C017-(下)

時間區間: 2026-07-31 13:00 ~ 2026-09-01 10:19

最大值: -76.9 °C

最小值: -80.5 °C

平均值: -78.7 °C

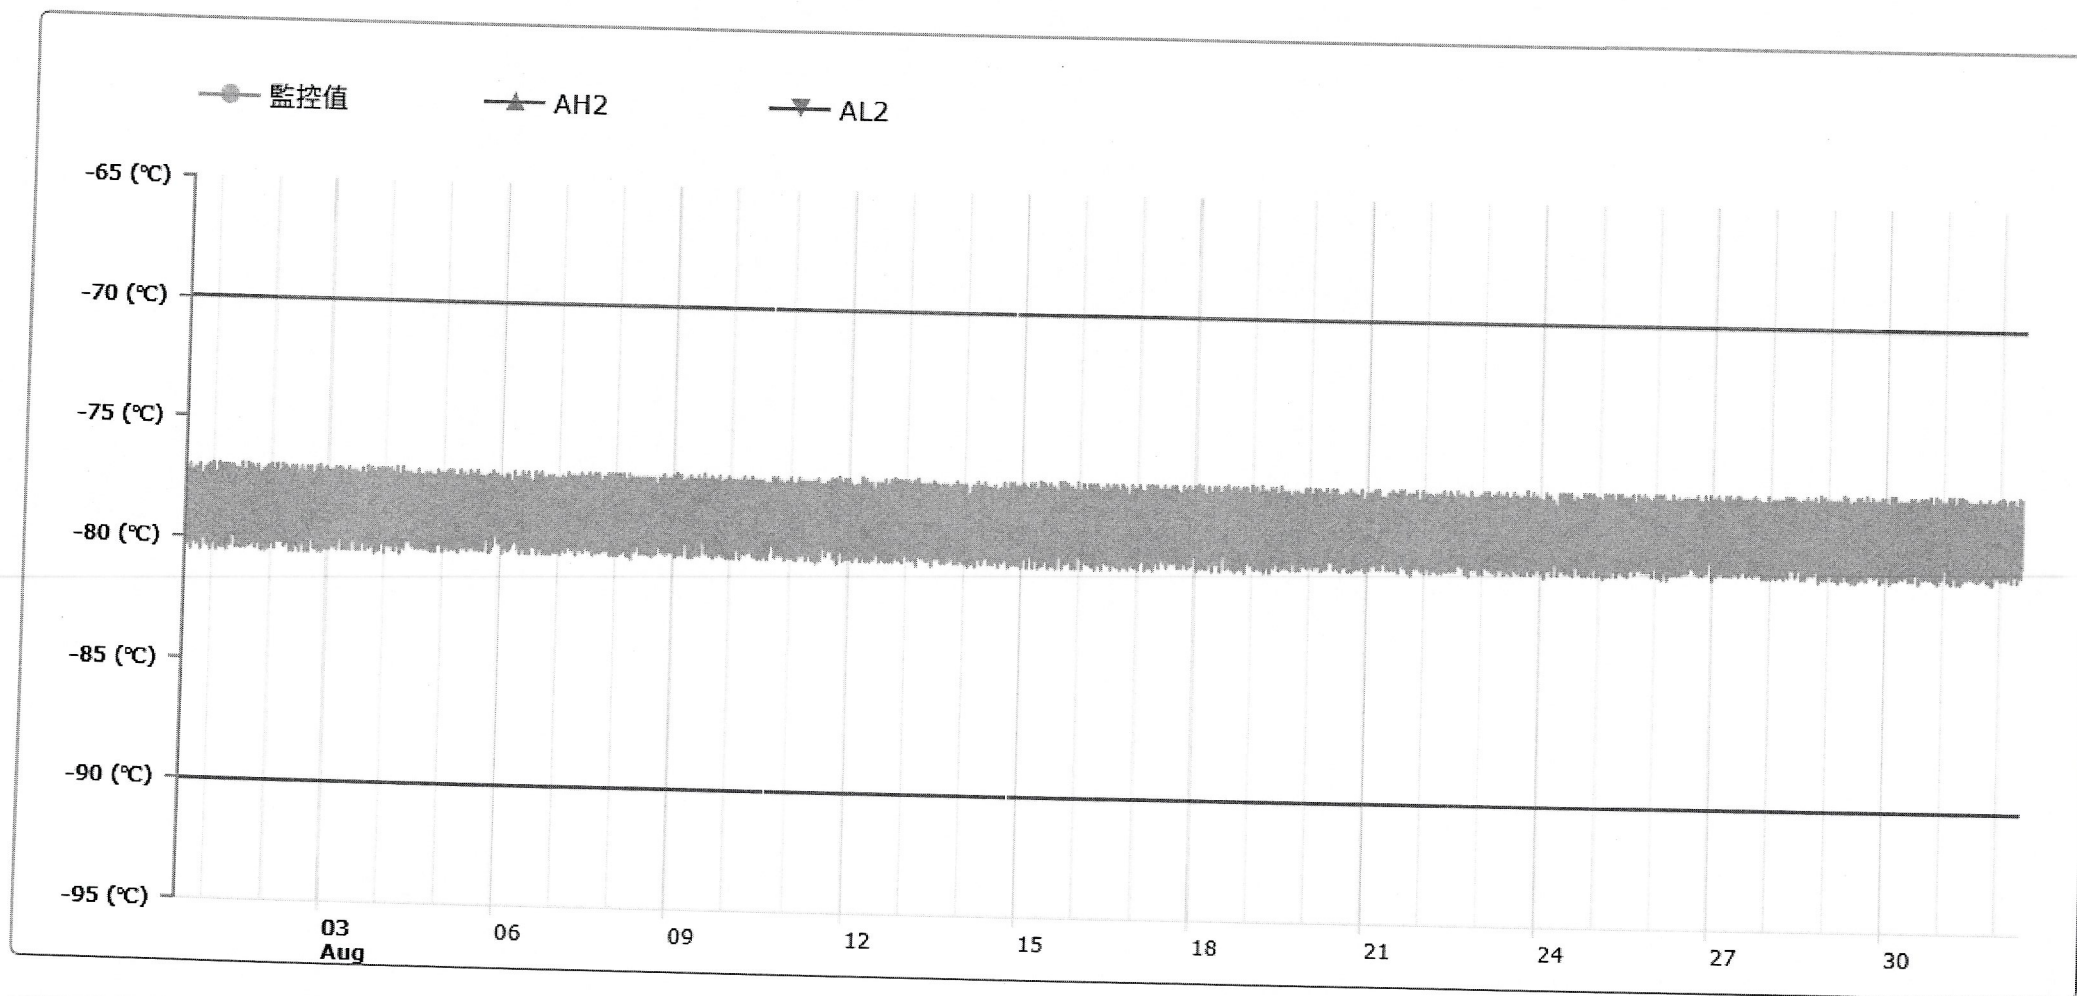

製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yuanas
01 Sep 2026

單位主管:

藥學部
科主任劉兆鴻

0901
1500