

# 監控點圖表


監控點: 547-急診BI-臨床藥局-PHCL-C017-(下)

時間區間: 2026-08-31 12:00 ~ 2026-10-02 08:58

最大值: -76.6 °C

最小值: -80.5 °C

平均值: -78.7 °C

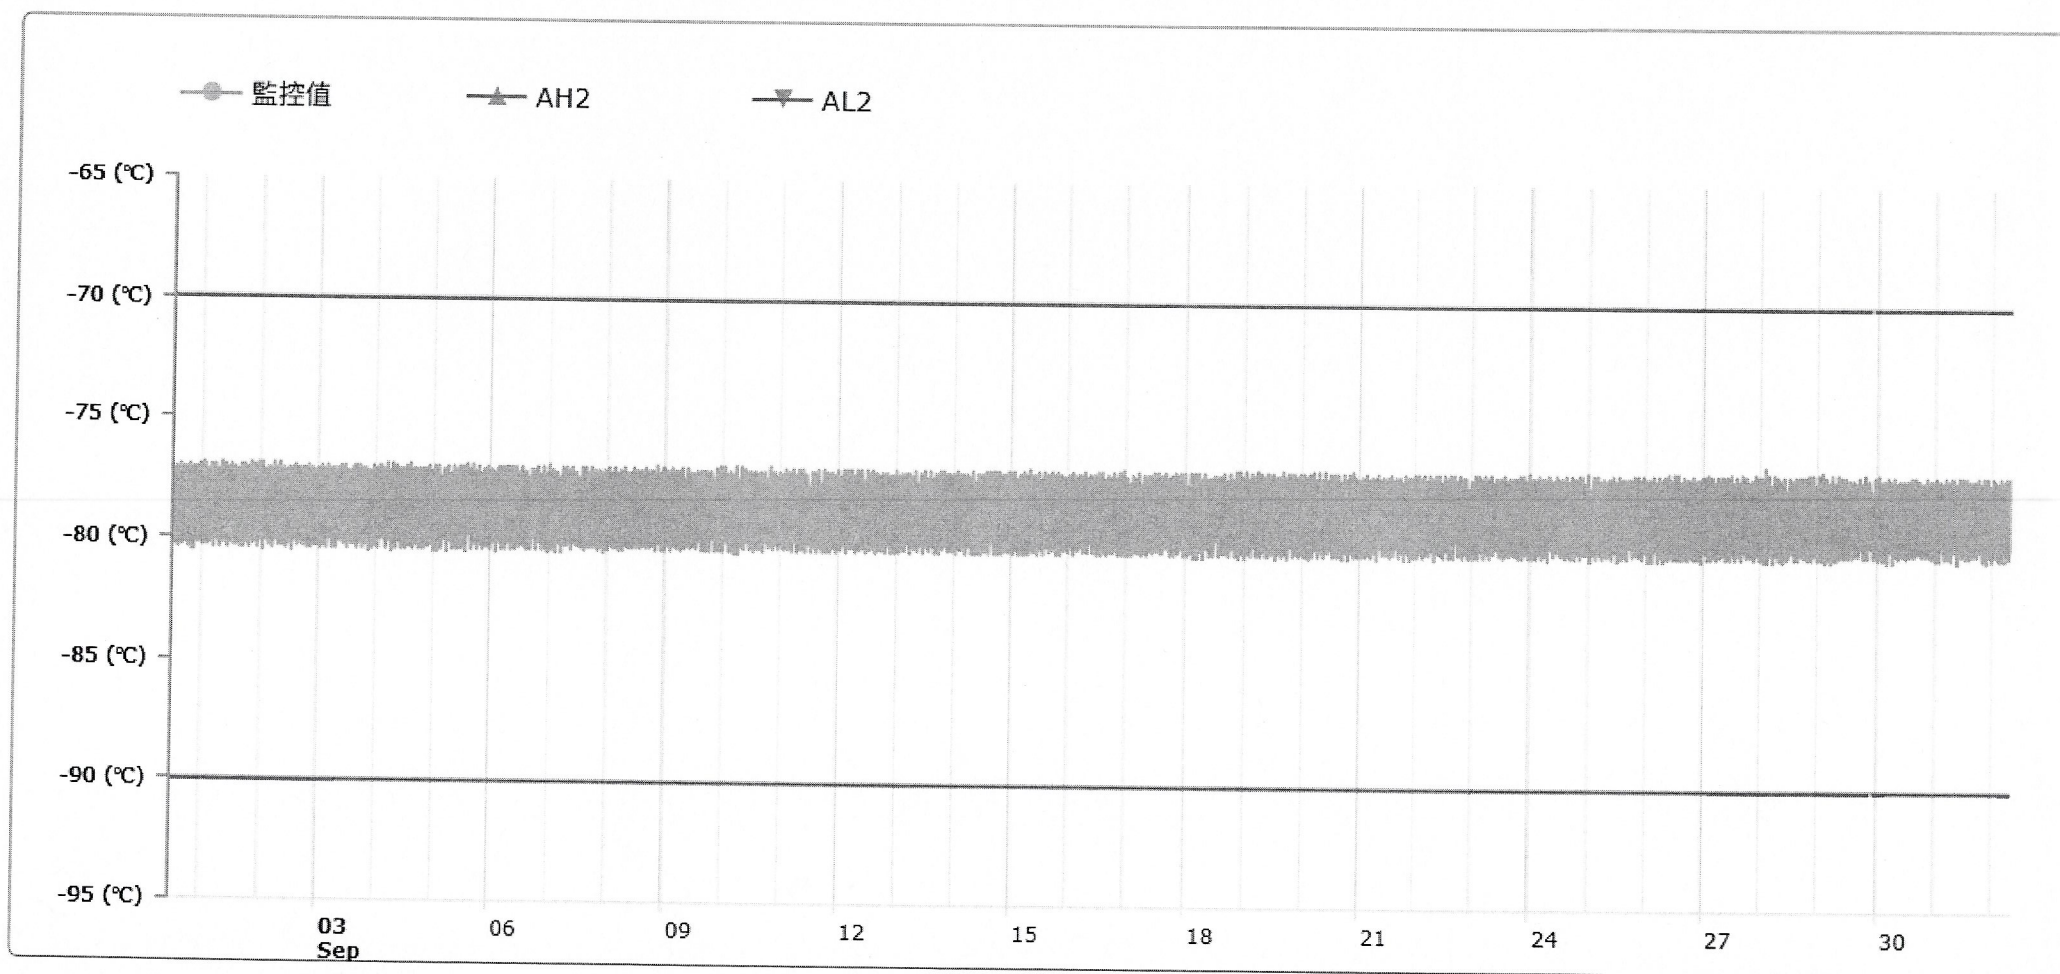

製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

yuanes  
02002206

單位主管:

藥學部劉兆鴻 1005  
科主任劉兆鴻 1500