

# 監控點圖表


監控點: 152-急診4F-檢體儲存室-80°C-1-上

時間區間: 2024-06-01 00:00 ~ 2024-06-30 23:59

最大值: -77.2 °C

最小值: -82 °C

平均值: -81.1 °C

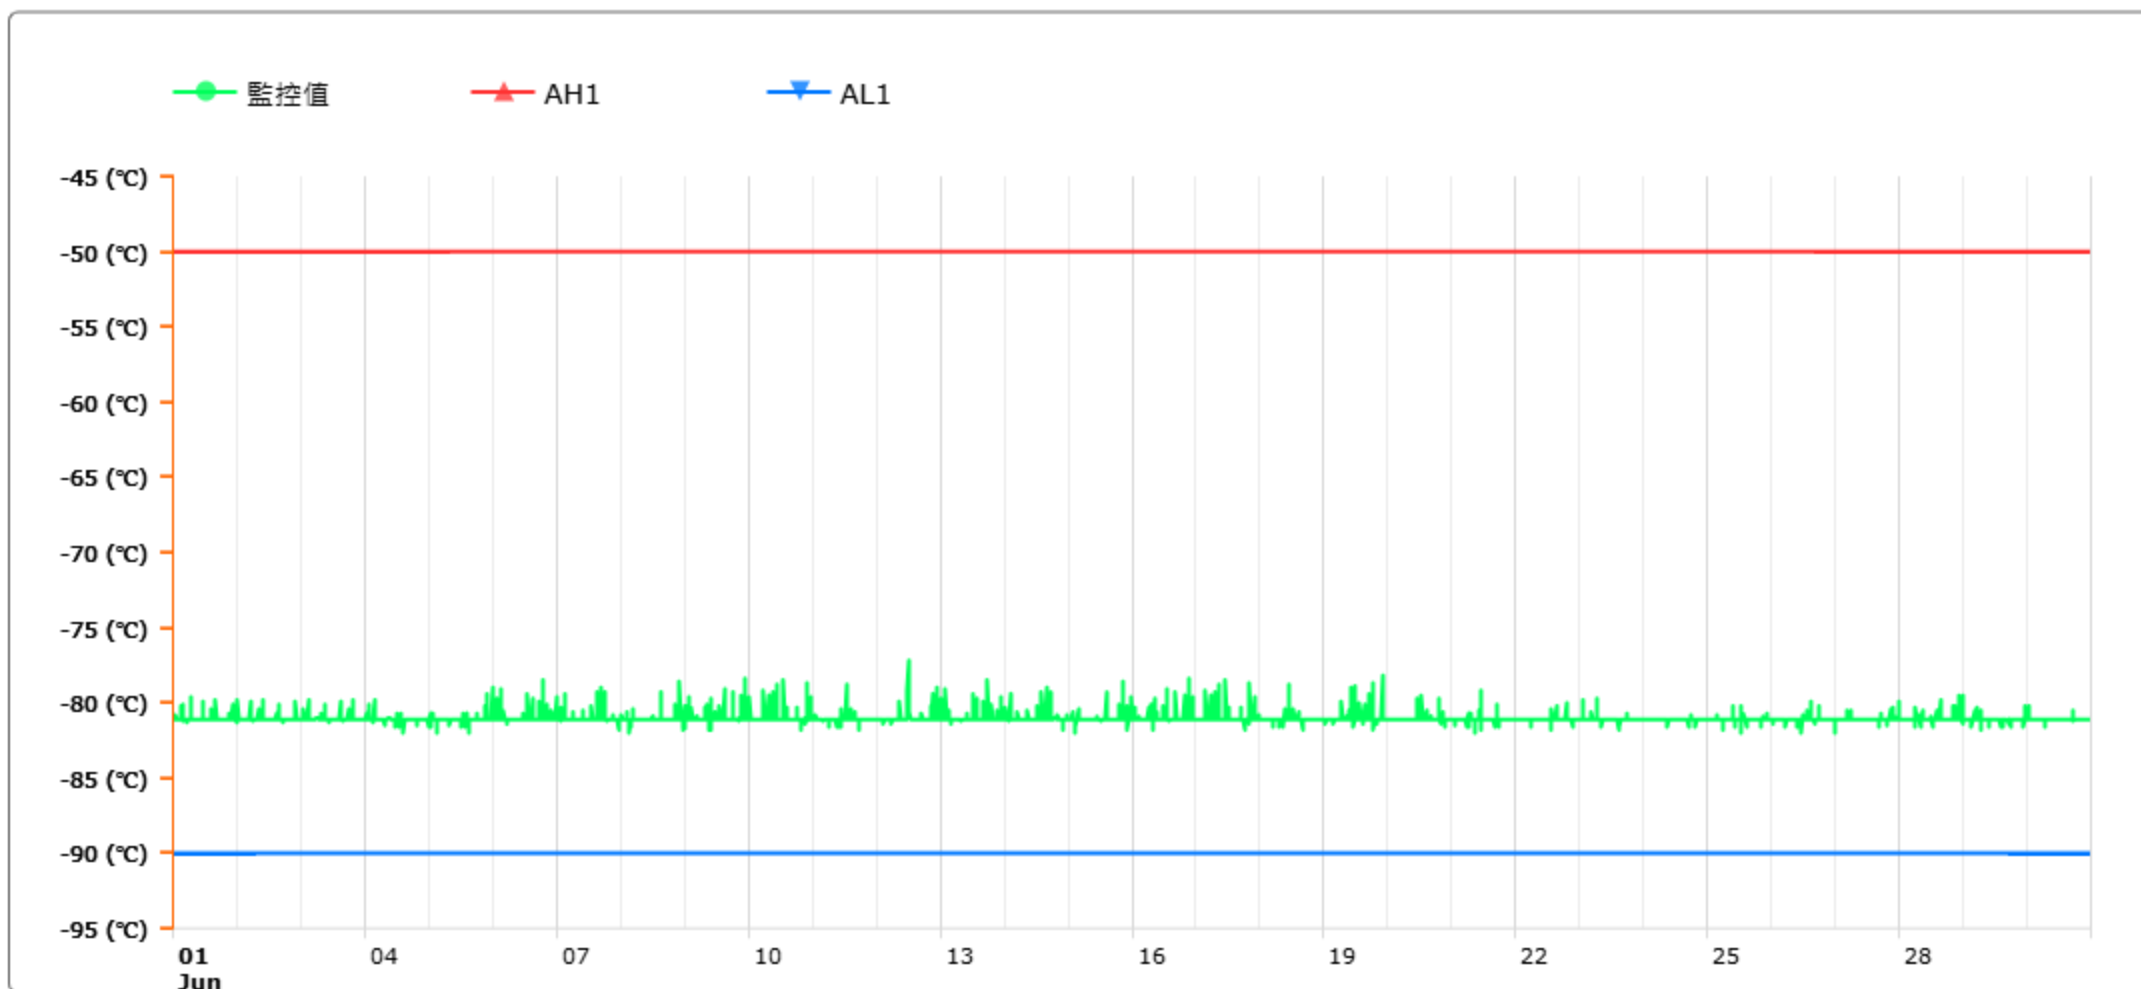

製表者: 臨床試驗中心

單位主管: